

ORTHORA 200

AUSSTATTUNG


2412

PRAXIS

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

FACHHÄNDLER


| |
|--|
| |
| |

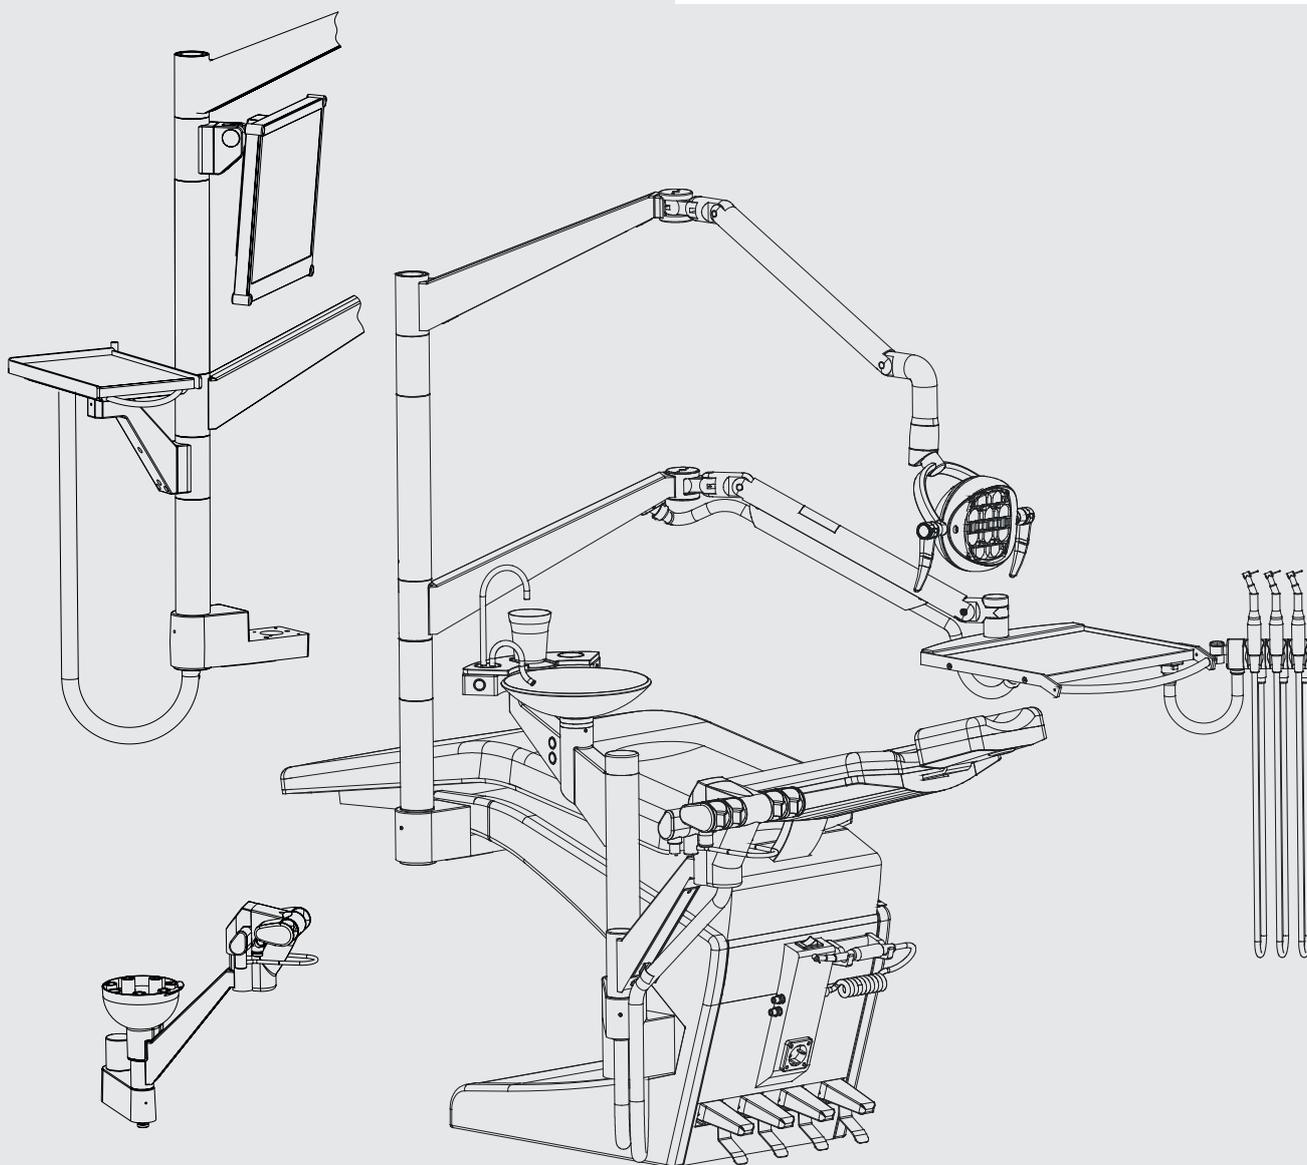

320.8715.01 / 2412

| Bedienung | Netzspannung | Steckdosen Norm | Farbe | Polster | Absaugung |
|---|--|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rechtshänder <input type="checkbox"/> Linkshänder | <input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 100V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz | <input type="checkbox"/> Schuko <input type="checkbox"/> CH T13 <input type="checkbox"/> US/CAN <input type="checkbox"/> F/B | <input type="checkbox"/> RAL (Standard) RAL-Nr. _____ <input type="checkbox"/> Metallic (Aufpreis) Bezeichnung MIK _____ | Mikrona "T" Polster <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Memory Farbe: _____ | <input type="checkbox"/> Trockenabsaugung <input type="checkbox"/> Nassabsaugung <input type="checkbox"/> Keine |

Re.Formance Linie Arbeitssessel



Re.Forma Hi.
Anzahl: _____



Re.Forma
Anzahl: _____




Re.Forma Lite.
Anzahl: _____

Standard
Basis schwarz


Optionen
 Basis verchromt
 Höhenverstellung über Fussplatte (chrom)

Bezug
 Lederbezug wie Unit
 Lederbezug _____



Armstütze
 Ja
 Nein

Achtung!
 Armstütze darf in Kombination mit ORTHODESK 320.6545.xx aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht verwendet werden.

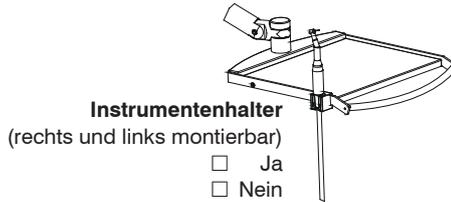

Instrumentenhalter
 (rechts und links montierbar)
 Ja
 Nein

Instrumentenhalter mit
 Mikromotor MX & MX2
 Mikromotor MC3
 oder Turbineneinrichtung
 Ultraschallgerät EMS
 Ultraschallgerät Satelec
 Dreiwegspritze LUZZANI
 Sechswegspritze LUZZANI



ORTHORACK

ORTHORACK Hinterkopfblage (HKA)

- HKA verbunden mit OT200
 Luft/Wasser-Anschluss an OT200
 Luft/Wasser-Anschluss an HKA

Autonome Wasserzuführung

- Ja
 Nein

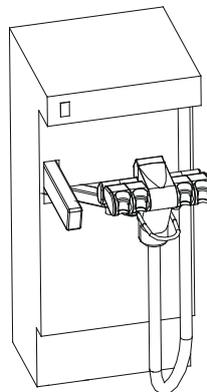



Ablage mit Absaugung

- Ja OP-Sauger
 Speichelzieher
 Nein

Instrumentenablage (max. 4 Instr.)

- Mikromotor MX2 LED
 I-Schlauch mit Wasserregulierung
 Mikromotor MC3 IR
 Mikromotor MC3 LED
 Turbineneinrichtung 4VML LUX
 Ultraschallgerät PIEZON, EMS
 Ultraschallgerät NEWTRON, Satelec
 Dreiwegspritze LUZZANI
 Sechswegspritze LUZZANI
 Polymerisationsleuchte MINI LED ORTHO

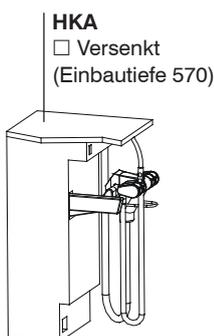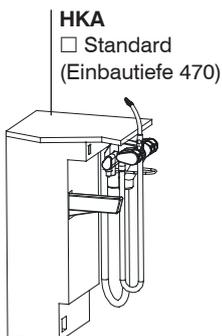

iPad-Halter

an Schwebetisch


- iPad mini 1 / 2 / 3 / 4
- iPad Air2 & Pro9,7 & 9,7"
- iPad Pro 10,5" & Pro 11" (2018) & 10,2"

Multimedia

- Ja
- Nein

Adaption

- LCD-Bildschirm 22" an Aufbaustange
- Intraoral Kamera



OP-Leuchte

- Ja
- Nein

Leuchte

- OP-Leuchte LED MIKRONA (Lampenkopf, RAL 9006)
 - Sensor Schalter
- OP-Leuchtenarm Verlängerung
- Decken OP-Leuchte LED MIKRONA (Polaris)
 - RAL 9002 RAL 9010 RAL 9016
 - kundenspezifische Lackierung
 - Sensor Schalter
- ORTHOLUX 200 LED (Deckenmodell, Farbe RAL 9002)



Schwebetisch


- Ja
- Nein

Schwebetisch

- ohne Instrumentenablage
- mit Instrumentenablage VARIO

Instrumentenablage (max. 3 Instrumente)

- Mikromotor MX2 LED
 - I-Schlauch mit Wasserregulierung
- Mikromotor MC3 IR
- Mikromotor MC3 LED
- Turbineneinrichtung 4VML LUX
- Ultraschallgerät PIEZON, EMS
- Ultraschallgerät NEWTRON, Satelec
- Dreiwegspritze LUZZANI
- Sechswegspritze LUZZANI
- Ablage Pulverstrahlgerät
 - Microetcher Dento-Prep

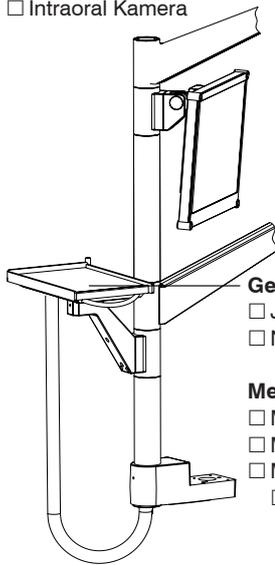

Geräte-Tray


- Ja
- Nein

Medienzuführung

- Medienzuführung 1
- Medienzuführung 2
- Medienzuführung 3
- Wasser über Wasserflasche

Ablage-Tray

- Ja
- Nein




Speifontäne

- mit Glasfüller
 - Ja Glasschale (Standard)
 - Keramikschale (optional)
- Nein

Wassertrennsystem

- Autonome Wasserzuführung
 - 0.8lt Flasche
 - 1.2lt Flasche
- Metasys Wasserentkeimung & Trennsystem WEK



Ablage mit Absaugung



- Ja OP-Sauger
- Speichelzieher
- Nein

Instrumentenablage (max. 4 Instrumente)

- Mikromotor MX2 LED
 - I-Schlauch mit Wasserregulierung
- Mikromotor MC3 IR
- Mikromotor MC3 LED
- Turbineneinrichtung 4VML LUX
- Ultraschallgerät PIEZON, EMS
- Ultraschallgerät NEWTRON, Satelec
- Dreiwegspritze LUZZANI
- Sechswegspritze LUZZANI
- Ablage Pulverstrahlgerät
 - mit Luftkupplung Microetcher
 - ohne Luftkupplung Dento-Prep

Instrumentenspülung

- CleanHub

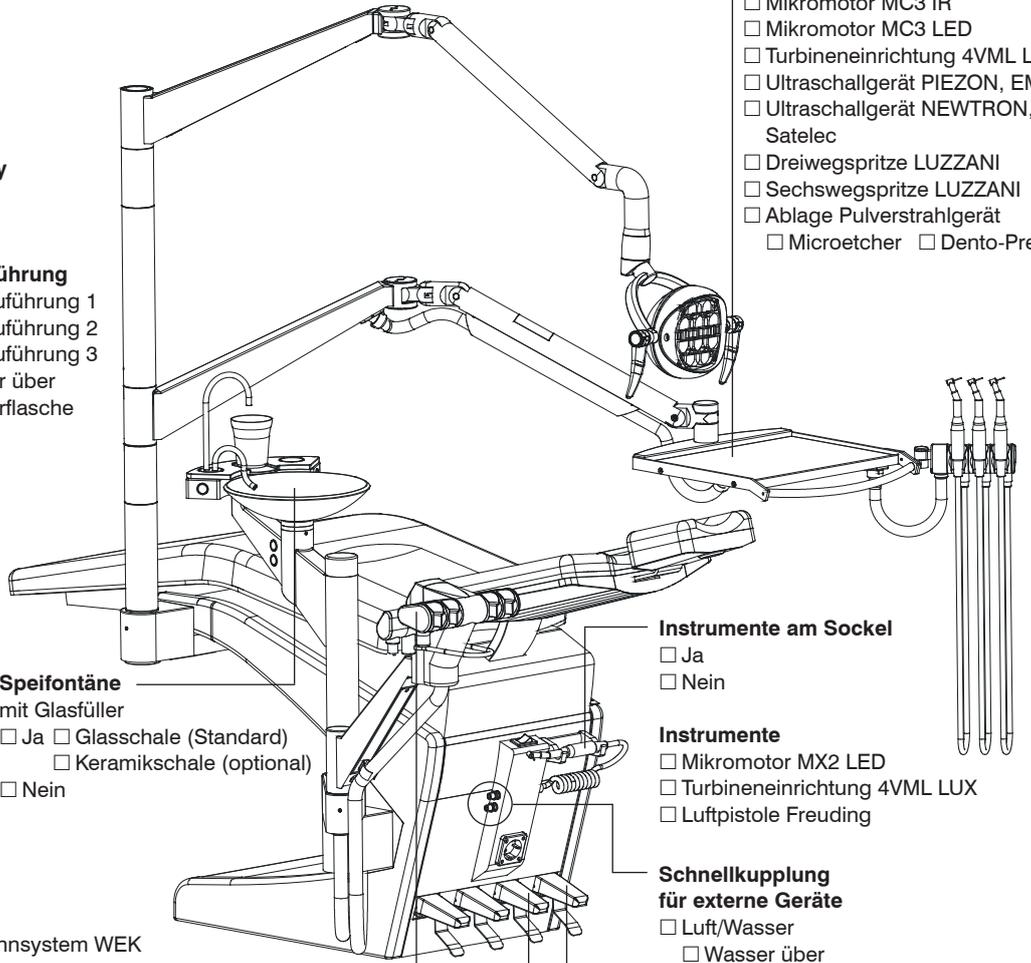

Instrumente am Sockel

- Ja
- Nein

Instrumente

- Mikromotor MX2 LED
- Turbineneinrichtung 4VML LUX
- Luftpistole Freuding

Schnellkupplung für externe Geräte

- Luft/Wasser
 - Wasser über Wasserflasche
- Luft

Instrumentenbedienung

- 4-Funktionspedal DYN
- 5-Funktionspedal
- Pedal
 - eingebaut (Standard)
 - freistehend (optional)





3-Funktionspedal zur Steuerung von Sonderfunktionen

- Ja
- Nein

Steuerfunktionen

- ORTHOLUX 200
- OP-Leuchte EIN/AUS
- Sonderfunktionen

ORTHODESK

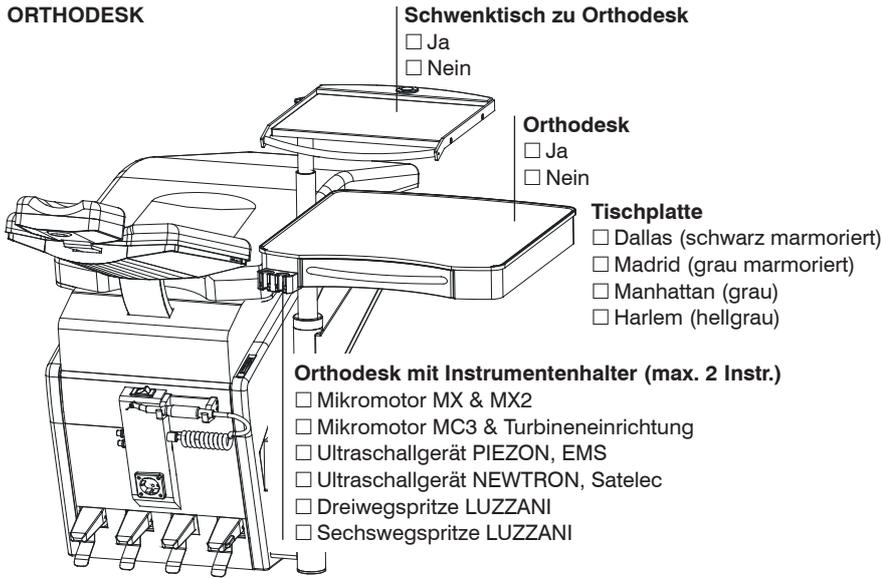

Medienzuführung Orthodesk

- Ja (nur möglich, wenn kein Instrument am Sockel)
- Nein

Medienzuführung (2 Instrumente)

- Mikromotor MX & MX2
 - Mikromotor MC3 IR
 - Mikromotor MC3 LED
 - Turbineneinrichtung 4VML LUX
 - Dreiwegspritze LUZZANI
 - Sechswegspritze LUZZANI
- } max. 1 Instr.

Datum:

Visum: